ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

Автоклав Q72B/Q52B

линейка горизонтальных автоклавов на 18/23 литра с водной системой охлаждения



Автоклав Q72B/Q52B – линейка горизонтальных автоклавов на 18/23 литра с водной системой охлаждения.

Компактные и надежные автоклавы этой модели являются идеальным решением для медицинских учреждений различного профиля с малым и средним потоком пациентов, где необходима быстрая и надежная стерилизация.

Стерилизация «класса B» за 16 минут.

Цикл стерилизации у автоклавов с водной системой охлаждения меньше, чем с воздушной. Это обеспечивает быструю смену инструментов и позволяет работать в режиме «один пациент – одна стерилизация». Цикл «Быстрая стерилизация» длится всего 16 минут, включая фазы «пред вакуум» и «сушка».

Рассчитан для работы со всеми типами инструментов, упакованными в защитные покрытия.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12



Непрерывная стерилизация – 7/24.

Конструкция и технические характеристики прибора позволяют проводить процесс стерилизации 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Нет необходимости делать паузы между циклами стерилизации.

Объем стерилизационной камеры можно выбрать с учетом потока инструментов – 18 или 23 литра.

Защита инструментов.

Точный контроль температуры и давления по всему объему стерилизационной камеры обеспечивает равномерное нагревание инструментов, включая инструменты с внутренними полостями. Это гарантирует качество процесса стерилизации и сохранность дорогостоящих инструментов.

Цветной сенсорный дисплей управления

Простое пользовательское меню дает возможность легко управлять автоклавом и контролировать весь процесс стерилизации. На цветном сенсорном экране отображаются основные параметры цикла стерилизации – температура, давление и время окончания цикла.

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

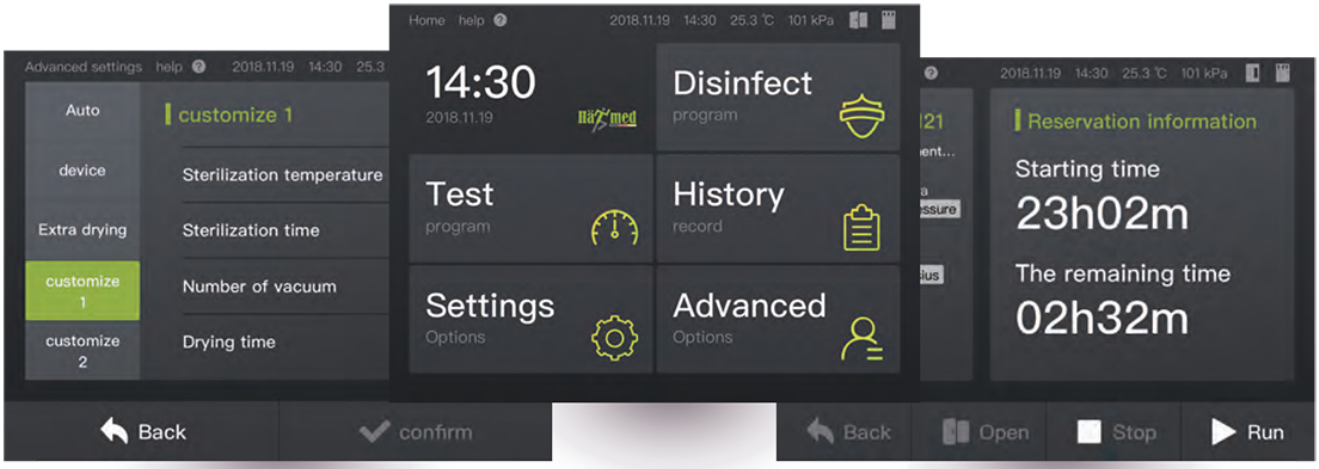

Безопасность

Электрический замок предотвращает открытие дверцы при процессе стерилизации. Уплотнительная термоустойчивая прокладка расположена по всему диаметру камеры, обеспечивая полную герметичность. Защитная система уравнивает давление в камере в автоматическом режиме при сбое питания, давая возможность извлечь инструменты.

Внешняя циркуляция воды

Дистиллированная вода подается из внешнего источника в автоматическом режиме. Автоклав оснащен системой контроля качества подаваемой воды. При плохом качестве воды процесс стерилизации прекращается.

Комплектующие от немецкого производителя

Основные узлы автоклава произведены в Германии. Вакуумная помпа с водяным охлаждением способна достигать уровня вакуума – 0.96 бар. Идеальное давление для качественной стерилизации. Конструкция камеры и система откачки обеспечивают полное удаление воды после каждого цикла стерилизации.

Надежность

Корпус автоклава сделан из нержавеющей стали марки 304, устойчивой к коррозии и окислению. При этом, передняя крышка сделана из цельного листа, что упрощает процесс очистки.

- **Объем:** 18/23 литра;
- **Экран:** цветной LCD экран с диагональю 4.3 дюйма;
- **Дверной замок:** электрический контроль за закрытием двери;
- **Внешние габариты, мм:** 460x450x560/460x450x560;
- **Объем камеры, мм (диаметр x длина):** 253x360/253x460;

Юридична адреса: вул. Назарівська, 1, м. Київ, 01032.
Поштова адреса: а/с 51, м. Київ, 04073.
Тел.: +380 (96) 560-55-55, +38 (044) 467-52-23
E-mail: info@medexim.ua сайт: medexim.ua
Сервісний центр: +38 (044) 500 19 12

- **Вес, кг:** 54/57;
- **Интерфейс связи:** USB/ RS232;
- **Принтер (опционально):** внешний;
- **Лоток:** 3 уровневый лоток (5 уровневый лоток (опиця));
- **Уровень вакуума:** -0,96 бар;
- **Остаточная влажность:** меньше 0.1%